

Roues de compatibilité 7DL/7EL (VVC triple lumière)

Avertissement:

- Les roues de compatibilités ont été développées **spécifiquement pour les patients des unités 7DL et 7EL équipés de cathéters veineux centraux triple lumière (CVC)**. Les autres unités doivent se référer au tableau des compatibilités des médicaments injectables, disponible sur le [site de la pharmacie](#) et, au besoin, appeler l'assistance pharmaceutique au 31080.
- Les concentrations notées dans les roues de compatibilités correspondent aux concentrations maximales utilisées aux 7DL/7EL. Si les concentrations utilisées pour votre patient sont supérieures, il est nécessaire d'appeler l'assistance pharmaceutique au 31080.
- La chimiothérapie et les produits sanguins doivent être passés seuls sur la voie proximale du CVC.

Mode d'emploi des roues de compatibilités

Voie

Identification de la lumière correspondant à la roue présentée. La couleur correspond à celle de l'embout du cathéter utilisé.

Voie distale

Hydratation de base
NaCl 0.9%+héparine

Horaire

Correspond à l'horaire habituel de passage des différents traitements. L'horaire peut être décalé tant que la séquence d'administration est respectée.

Lecture d'une roue

Sur cet exemple, on voit que les médicaments **a**, **b**, **c** et **d** pourront être passé simultanément en Y sur la rampe.


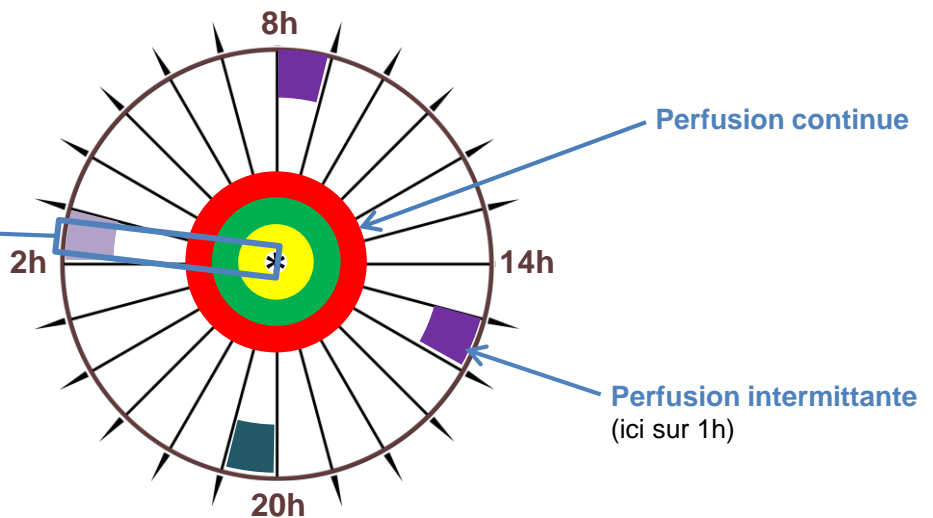



Schéma de montage

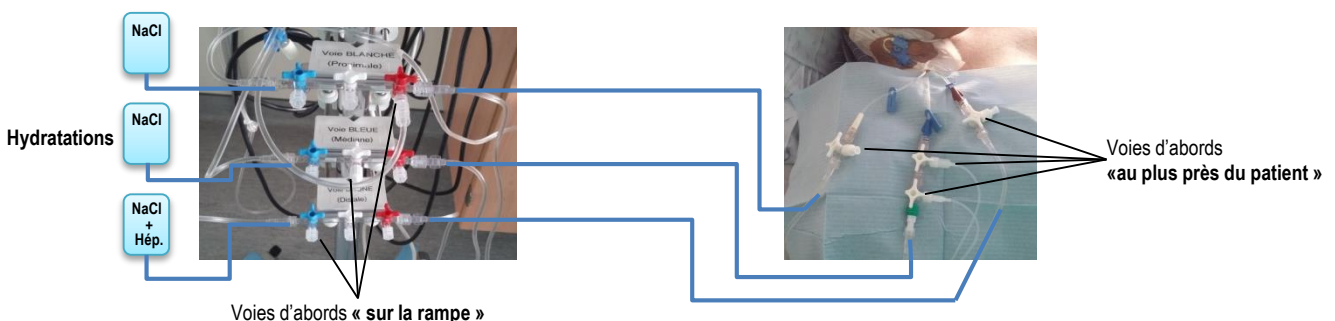

Roues de compatibilité 7DL/7EL (VVC triple lumière)


Voie proximale

Hydratation de base
NaCl 0.9%

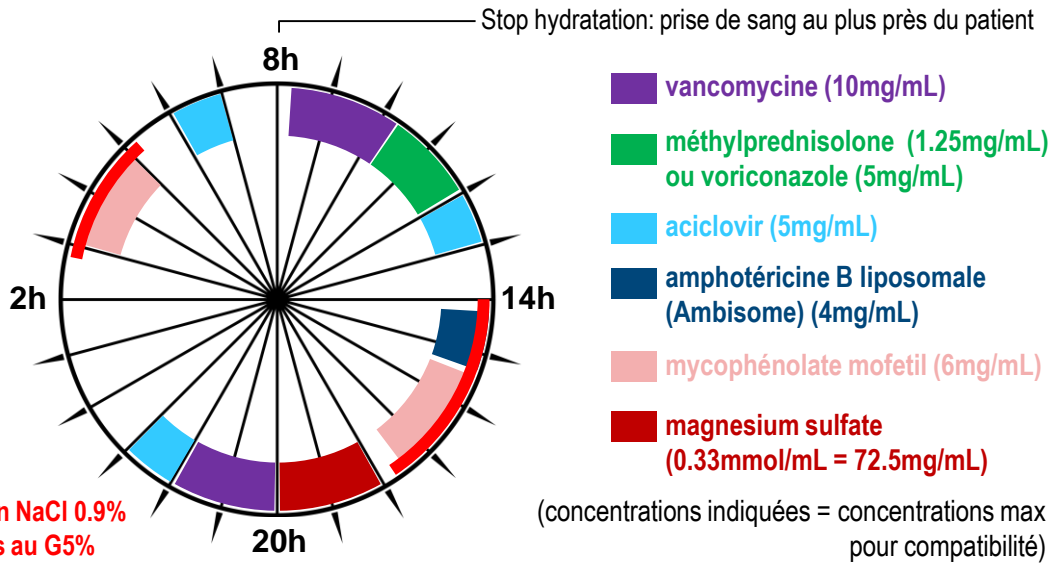

Voie médiane

Hydratation de base
NaCl 0.9%

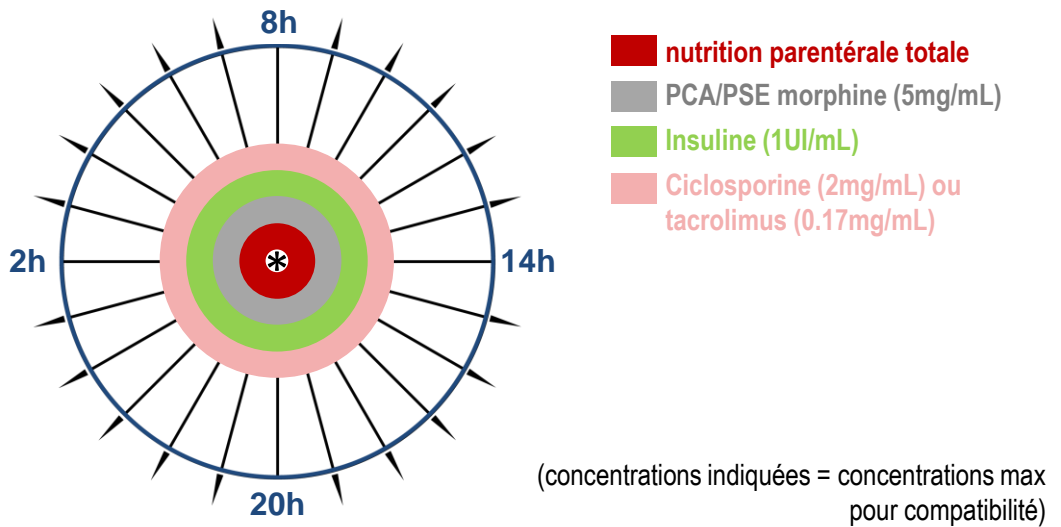

Voie distale

Hydratation de base
NaCl 0.9%+héparine

